



Consumer and
Corporate Affairs Canada

Legal Metrology

Consommation
et Corporations Canada

Métrieologie léale

APPROVAL No. - N° D'APPROBATION

S.WA-T2029 Rev. 3

JUN
JUIN 18 1984

NOTICE OF TEMPORARY APPROVAL

THIS REVISION SUPERSEDES NOTICES OF
TEMPORARY APPROVAL S.WA-T2029 revision 1
AND 2.

Manufacturer: Beck & Co. (Meters) Ltd.,
Streatham Vale
London, U.K. SW16-5NP

Canadian Representative:

Bennett Pump Canada Ltd.,
8 Finley Ave.,
Bramalea, Ontario
L6T 1A9

Description of Device: Liquid propane
dispenser

Rating: 5 to 50 LPM

Model Number: 4612, 4615

Display: Veeder-Root register 2002E or
Kraus register MICON-100IP

Meter: MIGAS - 4 piston meter with O-ring
seals.

Terms and Conditions

Purpose of Use: Use in trade is
permitted for the purposes of dispensing,
measuring and establishing a charge for
the liquid propane delivered.

Manner of Use: Use in trade is permitted
in accordance with sound measurement
practice and with instructions for use
provided by the manufacturer.

AVIS D'APPROBATION TEMPORAIRE

CETTE REVISION REMPLACE LES AVIS
D'APPROBATION TEMPORAIRE S.WA-T2029
revision 1 ET 2.

Fabricant: Beck & Co. (Meters) Ltd.,
Streatham Vale
London, U.K. SW16-5NP

Représentant Canadien:

Bennett Pump Canada Ltd.,
8 Finley Ave.,
Bramalea, Ontario
L6T 1A9

Description de l'appareil:
Distributeurs de propane liquéfié

Débit: 5 à 50 L/M

Numéro de modèle: 4612, 4615

Indicateur: enregistreur Veeder-Root
2002E ou enregistreur Kraus MICON-100IP


Compteur: MIGAS compteur à 4 pistons
avec joint d'étanchité "O" ring.

Conditions

Utilisation: L'utilisation commercial
est autorisée aux fins de distribution,
de mesure et de facturation pour le
propane liquéfié livré.

Modalité d'utilisation: L'utilisation
commerciale est autorisée selon les
pratiques établies dans le domaine de la
mesure et selon le mode d'emploi fourni
par le fabricant.

.../2

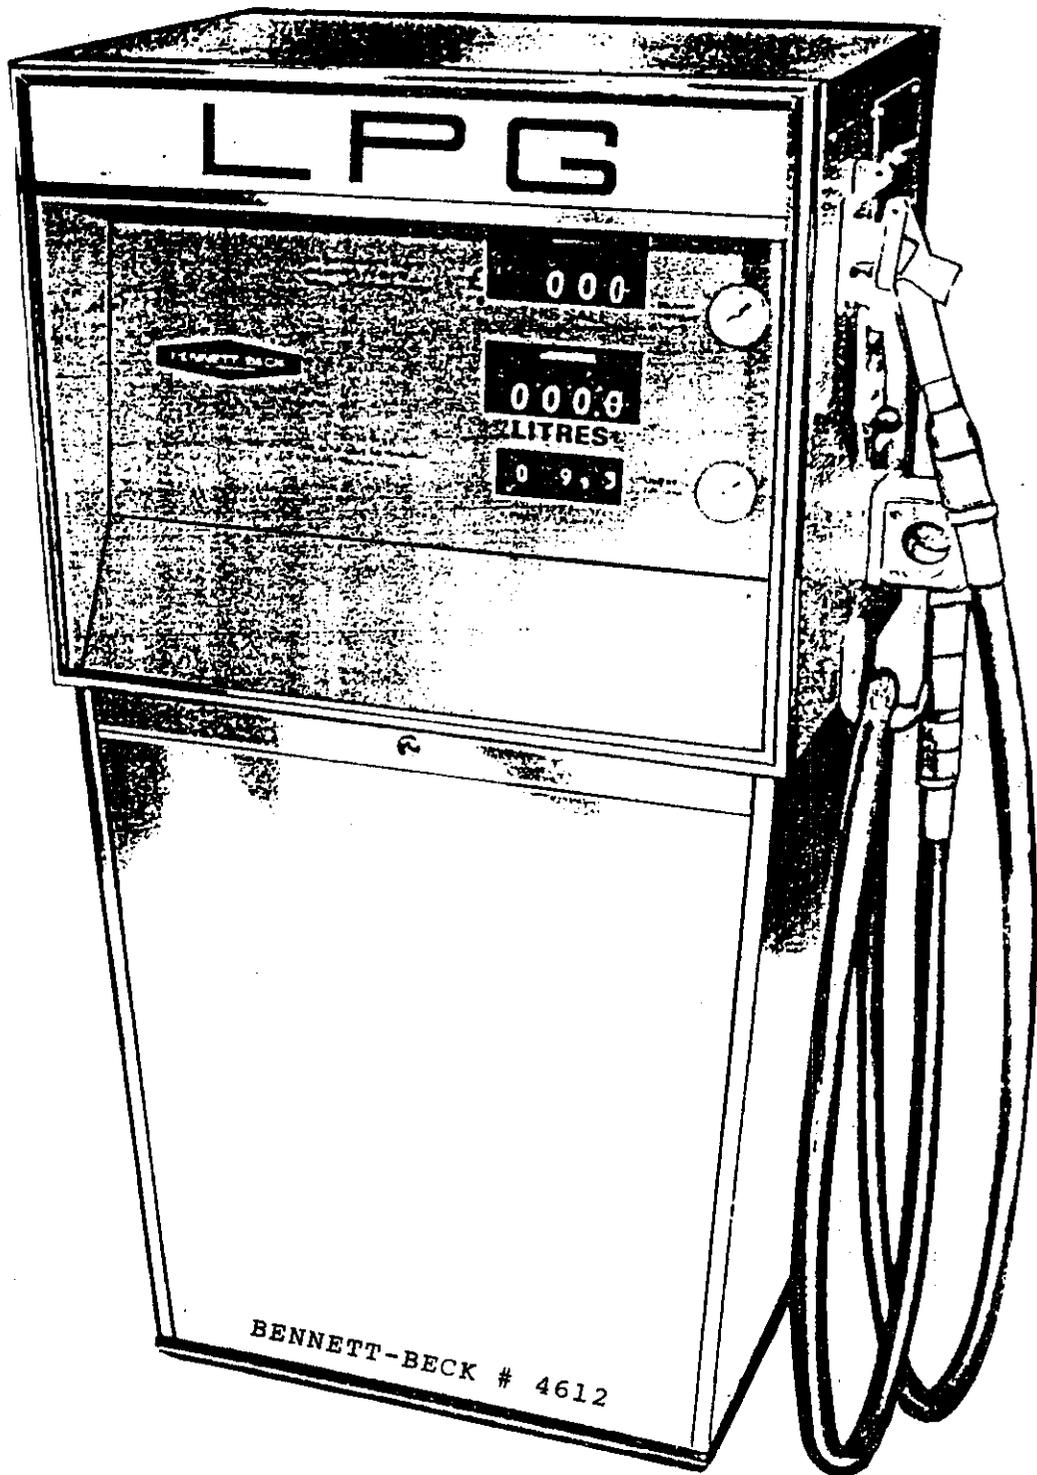

Specifications for Installation and Use:

A dispenser for liquified propane motor fuel that has a buried supply line from storage to the dispenser shall be installed with a product return line and the product return line shall be provided with a liquid filler valve with $1\frac{1}{4}$ " ACME male thread so that the delivery nozzle of a master meter may be connected to it and propane returned to storage at rates of at least 45 L/M.

Special Conditions: These devices are exempt from Section 247 of the Weights and Measures Regulations. Each new device is to be initially inspected and each repaired device is to be tested with propane using a pipe prover or master meter of a design acceptable to the Legal Metrology Branch.

Required Markings: Markings shall be shown on all devices of the type described in Part I hereof in accordance with the applicable requirements of the Weights and Measures Regulations.

Other Terms and Conditions: Unless its extension is authorized in writing by the undersigned, this temporary approval expires June 1, 1986, or upon approval being granted or denied pursuant to subsection 3(1) of the Weights and Measures Act, whichever occurs first. Upon expiry of this temporary approval, all devices which have been installed for use in trade under its authority shall be removed from service or, if approval has been granted pursuant to subsection 3(1) of the said Act, shall be modified as necessary to conform to all terms and conditions specified in that approval.

Spécification pour l'installation et l'utilisation: Un distributeur de propane liquéfié, pour les véhicules moteurs, ayant une ligne d'alimentation sous terre, du réservoir d'entreposage au distributeur devra être installée avec une ligne de retour du produit et celle-ci devra être équipée d'une vanne ayant des filets mâles, genre ACME de $1\frac{1}{4}$ " permettant le raccord de la tuyère du compteur étalon afin que le propane liquéfié puisse être retourné dans le réservoir à un régime d'au moins 45 L/M.

Conditions particulières: Cet appareil est exempté des exigences à l'article 247 du règlement sur les poids et mesures. Chaque appareil nouveau doit être initialement inspecté et chaque appareil réparé doit être éprouvé avec du propane en utilisant un tube ou un compteur étalon de type et de modèle approuvé par la Direction de la Métrologie légale.

Inscription prescrites: Tous les appareils du type décrit à la Partie I ci-dessus devront porter les inscriptions pertinentes prescrites par le règlement sur les poids et mesures.

Autres conditions: A moins que le sous-signé n'autorise par écrit une prolongation, la présente approbation temporaire demeure en vigueur jusqu'au 1er juin 1986 ou, jusqu'au moment où l'approbation est, soit accordée, soit refusée, conformément au paragraphe 3(1) de la Loi sur les poids et mesures, la première des deux échéances à survenir. Tous les appareils qui ont été installés aux fins d'utilisation commerciale en vertu des présentes, devront être retirés du service ou, si une approbation définitive est accordée conformément au paragraphe 3(1) de ladite Loi, tous les appareils devront subir les modifications précisées dans les conditions d'approbation définitive lors de l'expiration de la présente approbation temporaire.

Other Terms and Conditions: Continued


Prior to any sale of devices of the type described in Part I hereof, all of the terms and conditions specified in this Part shall be made known by the seller in writing to the purchaser.

Reference N°: G6953-W158-12

Autres conditions: Suite

Préalablement à toute vente d'un appareil du type décrit à la Partie I ci-dessus, le vendeur devra faire connaître par écrit à l'acheteur toutes les conditions susmentionnées.

N° de référence: G6953-W158-12



W.R. Virtue

Chief
Legal Metrology Laboratories

Chef
Laboratoires de la Métrologie légale

JUN
JUIN 18 1984