



Consumer and
Corporate Affairs
Canada

Consommation
et Corporations
Canada

Legal Metrology

Métrieologie Léegale

S.WA-3122

Approval No. d'approbation

Ottawa **MAR 3 1983**

NOTICE OF APPROVAL – AVIS D'APPROBATION

Company: Tokyo Electric Canada Ltd.
9 Meteor Drive
Rexdale, Ontario
M9W 1A3

Société: Tokyo Electric Canada Ltd.,
9 Meteor Drive
Rexdale, Ontario
M9W 1A3

Manufacturer: Tokyo Electric Co. Ltd.
1-14-10 Uchikanda
Chiyoda-Ku, Tokyo Japan

Fabricant: Tokyo Electric Co. Ltd.,
1-14-10 Uchikanda
Chiyoda-Ku, Tokyo Japan

Type of Device: Electronic digital
computing scale.

Appareil: Balance électronique à
affichage numérique.

Model No.: SL39-15

No. de modèle: SL39-15

Capacity: 15 kg x .005 kg.

Portée: 15 kg x .005 kg

Accessories: Compatible accessories that
meet the requirements and perform in
accordance with the Weights and Measures
Act, Regulations and Specifications may
be used.

Accessoires: Peuvent être utilisés tous
accessoires compatibles qui satisfont
aux exigences de la Loi, du règlement et
des prescriptions ministérielles
régissant les poids et mesures.

A remote indicator may be used.

On peut utiliser un téléindicateur.

Description: This is a fully electronic
digital computing scale. The customer
and operators displays consist of the
following:

Description: Il s'agit d'une balance
calculatrice, à affichage numérique,
entièrement électronique. Le panneau
d'affichage du client et celui de
l'opérateur sont composés des dispositifs
suivants:

- A 5 digit weight display
- A 5 digit unit price
- A 6 digit total price
- Annunciator lights that indicate zero,
net, prepack and 100 gram pricing.

- un indicateur à 5 chiffres pour
l'affichage du poids
- un indicateur à 5 chiffres pour
l'affichage du prix unitaire
- un indicateur à 6 chiffres pour
l'affichage du prix total
- des voyants pour la remise à zéro, le
poids net, le pré-emballage et le prix
par 100 grammes.

All digital displays are of the 7 segment
LED type green in colour and .5 inches
high.


Tous les indicateurs numériques sont à
DEL 7 segments de couleur verte et de
0.5 pouces de hauteur.

The operator has a console fitted with
the following controls.

Le pupitre de commande de l'opérateur
est muni des commandes suivantes:

- 1) A numeric keyboard (0 to 9) for input
of unit price or keyboard tare.

- 1) un clavier numérique (0 à 9) servant
à l'introduction du prix unitaire ou
de la tare:

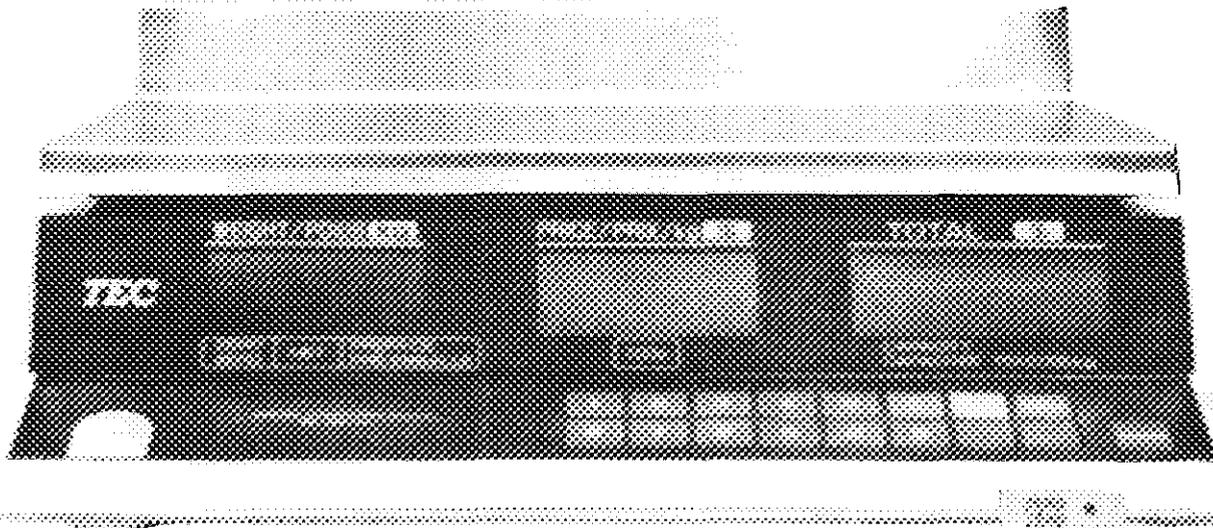

Description: Continued

- 2) An "S" key for prepack mode.
- 3) A "C" key for clearing unit price and prepack mode.
- 4) A "P/TR" key for keyboard or platter tare.
- 5) A "100g" key for 100 gram pricing.
- 6) A "POWER" key for OFF/ON.
- 7) A "ZERO" push button switch for zeroing the scale.

Two means of sealing are provided:

- 1) On RH side of scale near the operator, a door for access to the zero and span potentiometers can be wire sealed to a drilled head screw.

Description: Suite

- 2) une touche "S" utilisée pour le réglage en mode de pré-emballage;
- 3) une touche "C" qui sert à effacer le prix unitaire et à annuler le mode de pré-emballage;
- 4) une touche "P/TR" pour la détermination de la tare au clavier ou au plateau;
- 5) une touche "100g" destinée au calcul du prix par 100 grammes;
- 6) une touche "POWER" servant à la mise en marche ou l'arrêt de l'appareil;
- 7) un bouton-poussoir "ZERO" qui permet de remettre la balance à zéro.

Le plombage peut être effectué de deux façons:

- 1) Sur le côté droit de la balance, près de l'opérateur, la porte qui permet d'accéder aux potentiomètres du zéro et de la portée peut être plombée au moyen d'un fil métallique et d'une vis à tête perforée;

Description: Continued

- 2) Near where the fuse is located a tab can be wire locked to a drilled head screw securing the top cover to the base.

Special Conditions: The sealing means is exempt from providing ready access to components or adjustments as per SGM1/12.

Condition of Approval: Approval is granted under the Weights and Measures Act, S.C. 1970-71-72, chapter 36, and the Weights and Measures Regulations C.R.C.c., 1605 for use in Canada under the general conditions of the said Regulations, and under any special conditions listed above.

Reference No.: G6922-T280

Description: Suite

- 2) près du fusible, une attache peut être fixée à une vis à tête perforée au moyen d'un fil métallique de sorte que le couvercle soit assujetti au boîtier.

Conditions particulières: Le plombage n'est pas tenu de permettre l'accès facile aux composants ou dispositifs de réglage conformément à la prescription ministérielle SGM1/12.

Condition d'approbation: L'approbation est accordée conformément à la Loi sur les poids et mesures S.R.C. 1970-71-72, chapitre 36, et au règlement d'application C.R.C.c., 1605. L'emploi est autorisé au Canada sous réserve des conditions générales dudit règlement, et de toutes les conditions particulières formulées dans le présent avis.

No. de référence: G6922-T280


W.R. Virtue

Chief
Legal Metrology Laboratories

Chef
Laboratoires de la Métrologie légale

MAR 3 1983