



Consumer and  
Corporate Affairs Canada  
Legal Metrology

Consommation  
et Corporations Canada  
Métrologie légale

APPROVAL NO. N° D'APPROBATION

S.WA-3149

SEP 28 1983

### NOTICE OF APPROVAL

### AVIS D'APPROBATION

Company: Electronic Scale International  
P.O. Box 1087  
San Gabriel, California  
USA 91776

Société: Electronic Scale International  
P.O. Box 1087  
San Gabriel, California  
USA 91776

Manufacturer: Electronic Scale Int.  
San Gabriel, CA.  
USA 91776

Fabricant: Electronic Scale Int.  
San Gabriel, CA  
USA 91776

Type of Device: Electronic checkstand scale, or as a stand alone weigh scale.

Appareil: Balance de comptoir électronique qui peut être utilisée comme balance de pesage autonome.

#### MODEL NUMBERS Nº de modèles

#### CAPACITY Capacité

JK 703ab	15 kg x .005kg
JK 704ab	15 kg x .005 kg with remote digital display/ avec téléindicateur
JK 705ab	9.995 kg x .005 kg
JK 706ab	9.995 kg x .005 kg with remote digital display/ avec téléindicateur

Accessories: Compatible accessories that meet the requirements and perform in accordance with the Weights and Measures Act, Regulations and Specifications may be used.

Accessoires: Peuvent être utilisés les accessoires compatibles qui satisfont aux exigences de la Loi, du Règlement et des prescriptions ministérielle régissant les poids et mesures.

#### Options:

#### Options:

- 1) Remote digital weight display.
- 2) Compatible cash register as per list on addendum to this S.WA.

- 1) Téléindicateur de poids.
- 2) Une des caisses enregistreuses compatibles qui figurent dans le supplément du présent avis.


Description: A fully electronic scale utilizing a load cell, an A/D converter and a microprocessor that processes the weight signals which may be displayed on a remote indicator or interfaced to a cash register.

Description: Balance entièrement électronique qui fonctionne à l'aide d'une cellule de pesage, d'un convertisseur analogique-numérique et d'un microprocesseur. Ce dernier traite les signaux pondéraux qui peuvent ensuite être affichés sur un indicateur branché à distance. La balance peut également être reliée à une caisse enregistreuse.

.../2

Canada

- 2 -

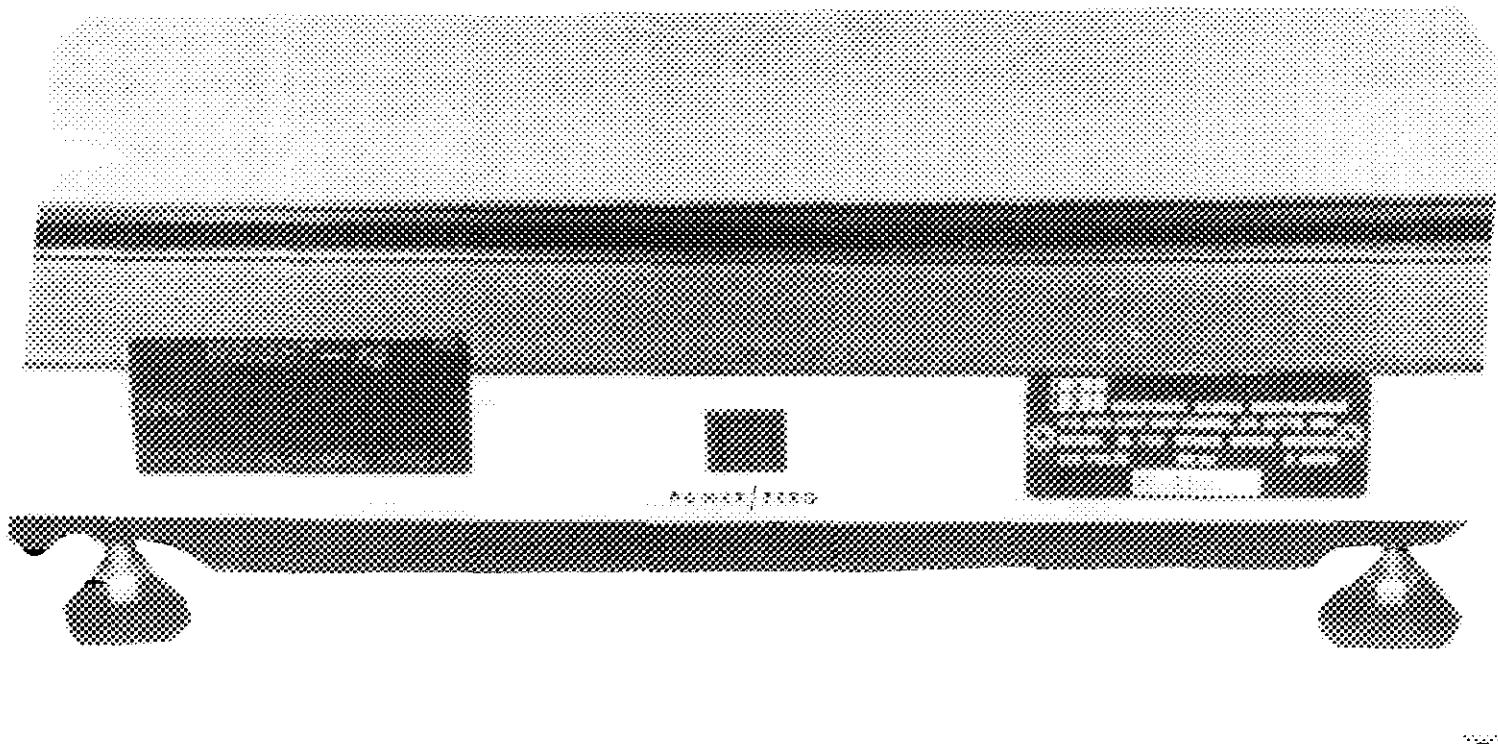

Testing: The display can be verified with the "ON/OFF" switch. When switched ON, the indicators will cycle through a complete display, i.e. 0 to 9 and then indicate 0.000.

Provisions for Sealing: The span and coarse zero adjustments will be sealed independently with drilled head screws, lead seal and wire, or with a tamper proof paper seal.

Special Conditions:

- (1) The sealing means is exempt from providing ready access to other components or adjustments as per SGM1/12.

Mise à l'essai: Le dispositif d'affichage peut être vérifié au moyen de l'interrupteur "ON/OFF". Lorsqu'il est réglé en position "ON", l'indicateur effectuera un cycle d'affichage complet, c'est-à-dire de 0 à 9 pour ensuite afficher 0.000.

Plombage: Les dispositifs de réglage de la portée et du zéro approximatif doivent être plombés séparément en utilisant des vis à tête perforée, un plomb et un fil de plomb, ou un sœu inviolable en papier.

Conditions particulières:

- (1) Le plombage n'est pas tenu de permettre l'accès facile aux autres composants ou dispositifs de réglage conformément à la prescription ministérielle SGM1/12.

- 3 -

Special Conditions: Continued

(2) The remote display unit must not be located more than two(2) metres from the weighing element and in no instance oriented at an angle greater than 45° from the customer's normal line of sight.

Conditions of Approval: Approval is granted under the Weights and Measures Act, S.C. 1970-71-72, chapter 36, and the Weights and Measures Regulations C.R.C.c., 1605 for use in Canada under the general conditions of the said Regulations, and under any special conditions listed above.


Reference No.: G6922-E103

Conditions particulières: Suite

(2) Le téléindicateur ne doit pas être installé à plus de deux mètres de l'élément de pesage. De plus, il ne doit jamais être orienté à plus de 45° par rapport à la ligne de vision normale du client.

Conditions d'approbation: L'approbation est accordée conformément à la Loi sur les poids et mesures S.R.C. 1970-71-72, chapitre 36, et au règlement d'application C.R.C.c. 1605. L'emploi est autorisé au Canada sous réserve des conditions générales dudit règlement et de toutes les conditions particulières formulées dans le présent avis.

Nº de référence: G6922-E103



W.R. Virtue

Chief  
Legal Metrology Laboratories

Chef  
Laboratoires de la Métrologie légale

SEP 28 1983